

Ne soyez pas laissé pour compte.



Restez au fait des meilleures pratiques, faites confiance au meilleur partenaire.

Pour commander : 1 800 668-5558 / www.henryschein.ca

CROSSTEX
A CANTEL MEDICAL COMPANY

Prenez une longueur d'avance en intégrant les meilleures normes de pratique. Depuis plus de 65 ans, Crosstex est un fournisseur de confiance en solutions et services de contrôle des infections.

Les règlements et les normes de contrôle des infections continuent leur évolution et doivent être mis à jour pour satisfaire aux besoins changeants des professionnels dentaires et médicaux. Nos connaissances, conscience et technologies s'améliorent, tout comme nos meilleures pratiques.

Vos conseillers et ressources Crosstex Canada sont disponibles pour assurer que vous ayez les renseignements les plus récents, les technologies de pointe et les produits les plus fiables pour votre cabinet.

Crosstex est un pionnier quant à divers produits et solutions de prévention des infections, de contrôle et de conformité qui sont devenues les normes de l'industrie.

Ne vous contentez pas de mois. Demandez ce qu'il y a de mieux pour votre cabinet. Communiquez avec votre distributeur agréé.


SAFE-FLO™ Pompes à salive et soupapes



Partager n'est pas toujours prudent.

Des études ont démontré que le reflux des pompes à salive peuvent survenir pour 1 patient sur 5.¹

Évitez d'exposer vos patients à la salive, au sang et à d'autres matières infectieuses des patients précédents.

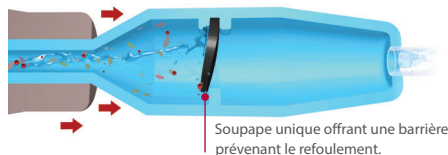

Soupape unique offrant une barrière prévenant le reflux.

Les pompes à salive SAFE-FLO^{MC} et les soupapes antiretour protègent contre le reflux pour la sécurité de vos patients.

100/sac

Pompe à salive SAFE-FLO^{MC}
M1000WHBU 100/pqt Blanc

Pompe à salive SAFE-FLO^{MC}
M1001CLBU 100/pqt Transp.

Soupepe SAFE-FLO^{MC} SE
M1010SUSE 100/pqt Bleu

Adaptateur SAFE-FLO^{MC}
M1020ADAP 50/pqt Bleu

Vidéo :
Crosstex.com/Safe-Flo



Pour en savoir plus : crosstex.com/safeflo

1. Miller C. 'ack flow' in low-volume suction lines may lead to potential cross-contamination. RDH. 1996;16(11):30.

Sans latex de caoutchouc naturel.

MEILLEURE PRATIQUE

Le reflux d'une pompe à salive à faible volume peut survenir lorsqu'un patient ferme la bouche autour de l'embout, formant un seau créant un vide partiel. Ceci peut résulter en des micro-organismes des conduites d'aspiration entrant dans la bouche, source potentielle de contamination croisée.

Faites un pas de plus pour assurer que le reflux ne soit pas possible avec les pompes à salive Safe-Flo.

DentaPure™ Clean Water. Clear Choice.™

Une installation simple.
Un an d'eau d'unité dentaire conforme.*



POUR L'AMOUR DE VOS PATIENTS ET DE VOTRE CABINET

Cartouche municipale
DP365M

Cartouche bout.
d'eau indépendante
DP365B

Pour en savoir plus :
crosstex.com

Toutes les déclarations sont basées selon l'utilisation de l'eau potable.

* Ou, 240 litres d'eau si les registres sont conservés.

La couleur du capuchon peut être noire ou blanche.

MEILLEURE PRATIQUE

Les conduites d'eau d'unités dentaires stimulent la croissance bactérienne et le développement de biofilm dus à la présence d'une tubulure étroite, des débits inconsistants, et le potentiel de rétraction des fluides buccaux. Le personnel dentaire et les patients peuvent donc être à risque d'effets secondaires si l'eau n'est pas traitée de façon appropriée.²

²CDC MMWR Guidelines for Infection Control in Dental Health-Care Settings — 2003 Dec 19;52(RR-17):28-29.

Obtenez 1 unité de FC

Cours gratuit sur le traitement des conduites d'eau

Enfants hospitalisés à cause de l'eau contaminée d'unités dentaires - ceci pourrait-il vous arriver?

Inscrivez-vous aujourd'hui à CrosstexLearning.com

Achetez 3
du même
obtenez 1
expédié avec la commande

Pour commander : 1 800 668-5558 / www.henryschein.ca

SURE-CHECK

Pochettes de stérilisation classe 4



Pour **CHAQUE CHARGE**.

Sure-Check^{MC} : la pochette originale de type 4.
Méfiez-vous des imitations!

N°	Description
	100/bte
SCL10152	10 x 15 po/25 x 38 cm
SCL12152	12 x 15 po/30 x 38 cm
SCL12182	12x 18 po/30 x 46 cm
	200/bte
SCXX2	2,25 x 4 po/ 6 x 10 cm
SCX2	2,75 x 9 po/7 x 23 cm
SCXS2	3,5 x 5,25 po/9 x 13 cm
SCS2	3,5 x 9 po/9 x 23 cm
SCW2	5,25 x 6,5 po/13 x 17 cm
SCM2	5,25 x 10 po/13 x 15 cm
SCL2	7,5 x 13 po/19 x 33 cm
	500/bte
SCS25	3,5 x 9 po/9 x 23 cm

Sans latex de caoutchouc naturel.

MEILLEURE PRATIQUE


Place a Type 4 (or higher) chemical indicator inside each package or use a Pouch with a Type 4 indicator built in.

Achetez 4 obtenez 1

de valeur égale ou moindre; expédié avec la commande

Enveloppes de stérilisation CSR

- Meilleure EFB (efficacité de filtration bactérienne) disponible*
- Hautement perméable (pas de paquets mouillés)
- En cellulose écologique
- Résistance exceptionnelle à la traction (mouillé ou sec)
- Pour les processus de stérilisation EtO ou vapeur
- Utilisation recommandé de deux couches pliées l'une après l'autre



N°	Description
	100/bte
SW12	12 x 12 po/30 x 30 cm
SW15	15 x 15 po/38 x 38 cm
SW18	18 x 18 po/46 x 46 cm
SW20	20 x 20 po/51 x 51 cm
SW24	24 x 24 po/61 x 61 cm

*Données au dossier.
Sans latex de caoutchouc naturel.

MEILLEURE PRATIQUE

Les instruments critiques et semi-critiques doivent être retraités d'une façon maintenant la stérilité durant l'entreposage. Les bons matériaux d'emballage comprennent des cassettes perforées emballées, pochettes à peler en plastique ou en papier, et enveloppes de stérilisation tissées ou non.

Achetez 4 obtenez 1

de valeur égale ou moindre; expédié avec la commande

STEAMPlusTM

Intégrateurs type 5

Utilisés lors des cycles à la vapeur, ils **produisent des résultats définitifs positifs ou négatifs** – permettant la libération de toute charge sans implant avant la réception du test de spores.



N°	Description
	100/bte
SSI-100	4 X 0,75 po

Pour **CHAQUE PAQUET** ou dans **CHAQUE CHARGE** pour plus d'assurance de stérilité.

MEILLEURE PRATIQUE

Pour la libération routinière de la charge, utilisez un indicateur de type 5 dans un PCD. Si le stérilisateur n'a aucun appareil d'enregistrement, un indicateur de type 5 **DOIT** être placé dans chaque paquet!
L'utilisation de SteamPlus^{MC} ne remplace pas un indicateur biologique.

Achetez 3 obtenez 2
expédié avec la commande

ConFirm^{MC} 10

Surveillance biologique en cabinet

Surveillance biologique avec lecture finale en 10 heures!



Vous pouvez maintenant satisfaire aux directives de surveillance biologique pour les stérilisateur à vapeur **en moins de temps...** avec ConFirm^{MC} 10, le premier système en cabinet produisant des résultats en **10 heures seulement**.

- **Facile à utiliser** – Traitez l'indicateur lors d'un cycle normal de stérilisation, suivi par une incubation de 10 heures pour le test et les fioles de contrôle.
- **Résultats faciles à lire** – Suite à l'incubation, si l'indicateur passe au jaune, ceci indique un échec
- **Rapide** – Lecture finale en 10 heures seulement.
- Broyeur d'ampoules **intégré** dans l'incubateur.

Test de spores **A TOUS LES JOURS** pour chaque type de cycle.

N°	Description
C10BI25	Indicateurs biol., vapeur (25/bte)
C10SK	Incubateur standard ConFirm ^{MC} 10 (journal, manuel) 110 V 141-NDB-601*

* Fabriquée à l'extérieur des É.-U.

MEILLEURE PRATIQUE

Un indicateur biologique **DOIT** être utilisé à chaque jour pour tester le stérilisateur utilisé ET pour chaque type de cycle utilisé. L'indicateur et le contrôle **DOIVENT** être inclus pour chaque charge contenant des appareils pour implants (p. ex. : implants dentaires, appareils d'ancrage provisoire, vis chirurgicales/plaques/broches), et l'emballage d'implants retenu jusqu'à l'obtention des résultats.

Achetez 4 obtenez 1
expédié avec la commande

AirView^{MC} II

Paquet de tests Bowie-Dick

- Pour détecter la présence d'air dans les stérilisateur à prévide
- Feuille d'indicateur facile à interpréter
- L'encre ne s'estompera pas suite à la stérilisation
- Conformité ISO 11140-5 Type 2



Utiliser en chambre vide suite au cycle de réchauffement

A CHAQUE JOUR.

N°	Description
MBD030	30/pqt 5 x 3,75 x 0,625 po / 13 x 10 x 2 cm

Not made with natural rubber latex



Pour les stérilisateur à prévide, le test d'enlèvement d'air doit être exécuté au début de chaque jour d'utilisation du stérilisateur.

Achetez 3 obtenez 1
expédié avec la commande

STEAMPlusTM

Paquet de test pour stérilisateur

Permet de libérer les charges sans implants en toute tranquillité d'esprit grâce à l'intégrateur STEAMPlus^{MC}, qui est joint à une carte du journal des charges.



N°	Description
STP-025	25/pqt 5 x 3,75 x 0,625 po / 13 x 10 x 2 cm (25 contrôles)



Pour la libération routinière de charges, utilisez un indicateur de type 5 à l'intérieur d'un PCD. S'il ne possède pas d'enregistreur, un indicateur chimique de type 5 DOIT être placé dans chaque paquet à libérer!

Achetez 4 obtenez 1
expédié avec la commande

Plume indicatrice de vapeur

Plume permettant aux utilisateurs d'identifier et de surveiller les articles lors du processus à la vapeur. L'encre passe du noir au rouge lors du traitement. Convient aux surfaces non poreuses (p. ex. : métal, verre ou plastique).

N°	Description
SIP-001	Plume indicatrice



L'étiquette d'un paquet doit inclure : date du travailleur en soins de la santé, de façon à ne pas perforer ni mouiller le paquet selon les directives canadiennes.

Écrire sur la partie laminée de la pochette en plastique/papier, tel que spécifié par les normes canadiennes.

Non-Latex, Lead-Free Steam Indicator Tape

- Helps to distinguish processed from unprocessed loads
- Easy-to-remove adhesive allows for secure seals
- Manufactured without latex or lead
- ISO 11140-1 Type 1 Compliant




N°	Description
STMF	0,75 po x 60 ver. / 1,9 x 55 cm

Sans latex de caoutchouc naturel.

SporView^{MC} Plus

Paquet de tests d'indicateurs biologiques

Permet de libérer immédiatement les charges sans implants en toute tranquillité d'esprit grâce à l'intégrateur SporView^{MC} Plus, qui est joint à une carte du journal des charges.



N°	Description
SBT-025	25/pqt 5 x 3,75 x 0,625 po / 13 x 10 x 2 cm (25 contrôles)
SBT-255	5" x 3.75" x 0.625" / 13 x 10 x 2 cm (5 Controls)



Pour la libération routinière d'une charge, utilisez un indicateur de type 5. Si le stérilisateur comprend un enregistreur, un PCD avec indicateur chimique de type 5 peut être utilisé pour justifier la libération de la charge retraitée.

Achetez 4 obtenez 1
expédié avec la commande

Registre des charges

Étiquettes et accessoires

Applicateur d'étiquettes

Extrêmement facile à charger, antiblocage et léger. Les étiquettes universelles peuvent être utilisées lors des processus à la vapeur, gaz EtO et peroxyde d'hydrogène.



N°	Description
SDG-001	Applicateur d'étiquettes



N°	Description
----	-------------

Étiquettes en papier

SUD-010-Y	Jaune (stériles sauf...)	10 roul./caisse
SUD-010-B	Bleu (stérile sauf...)	10 roul./caisse
SUD-010-G	Vert (stérile sauf...)	10 roul./caisse
SUD-010-R	Rouge (stérile sauf...)	10 roul./caisse
RER-010	Rouge, 2 lignes (stérile sauf...)	10 roul./caisse
PDL-010	Bleu (traité)	10 roul./caisse
DEL-010	DOUBLE (expiration)	10 roul./caisse
DDL-010	DOUBLE indicateurs	10 roul./caisse
BWL-010	Blanche, en blanc	10 roul./caisse
REL-010	Rouge (expiré)	10 roul./caisse
BEL-010	Bleu pâle (expiré)	10 roul./caisse
PEL-010	Violet (expiré)	10 roul./caisse
BWEL-010	Blanche, en blanc (expiré)	10 roul./caisse
KEL-010	Noir (expiré)	10 roul./caisse
XEL-010	Reflx bleu (expiré)	10 roul./caisse
BREL-010	Brun (expiré)	10 roul./caisse
GEL-010	Vert (expiré)	10 roul./caisse
BYEL-010	Or (expiré)	10 roul./caisse
PKEL-010	Rose (expiré)	10 roul./caisse
YEL-010	Jaune (expiré)	10 roul./caisse
GYEL-010	Gris (expiré)	10 roul./caisse
OEL-010	Orange (expiré)	10 roul./caisse

Applicateur d'étiquettes

Étiquettes universelles pour les processus de stérilisation à la vapeur, gaz EtO et peroxyde d'hydrogène.



N°	Description
MDG-001	Applicateur



N°	Description
----	-------------

Étiquettes universelles

UCE-010-K	Noir (expiré)	10 roul./caisse
UCE-010-R	Rouge (expiré)	10 roul./caisse
UCL-010	En blanc	10 roul./caisse
UCL-010-B	Bleu (stérilisé)	10 roul./caisse
UCL-010-G	Vert (stérilisé)	10 roul./caisse
UCL-010-K	Noir (stérilisé)	10 roul./caisse
UCL-010-R	Rouge (stérilisé)	10 roul./caisse
UCL-010-Y	Jaune (stérilisé)	10 roul./caisse
SCL-010-K	Noir 2 lignes (stérilisé)	10 roul./caisse
SCL-010-R	Rouge 2 lignes (stérilisé)	10 roul./caisse



Chaque étiquette doit inclure : date du retraitement, stérilisateur utilisé, numéro de cycle ou de la charge et les initiales.

Les étiquettes, rubans indicateurs chimiques, et encres manuelles ou imprimées doivent convenir au système d'emballage, et résistantes pour ne pas dégrader, couler, s'estomper ni devenir illisibles lors du processus de stérilisation.

Produits disponibles pour la chaleur sèche :



Bande indicatrice 4 pouces

Chaque bande d'indicateur chimique produit un **changement de couleur distinct** du vert au foncé lorsqu'exposée à la stérilisation.



Ensemble de culture SporView^{MC}

Le système d'indicateurs biologiques en cabinet produit des résultats clairs et faciles à interpréter. Homologués pour les cycles de stérilisation à la chaleur sèche, vapeur, EtO et vapeur chimique. Chaque boîte comprend des bandes de spores et cultures à transférer aseptiquement pour résultats finaux suite à une incubation de 7 jours. 20/bte ou 100/bte.




Pochette autoscellante en nylon

Pour processus à la chaleur sèche jusqu'à **420 °F / 215 °C**.

- Le nylon autoscellant est **transparent, résistant et à l'épreuve des ponctions**
- Étiquettes gratuites pour indicateurs chimiques externes
- Formats : 2x10 po 3x10 po, 4x10 po, 7x10,5 po, 9,5x13 po

N°	Description	
DIS-100	Bandes indicatrices de chaleur sèche	100/bte
N°	Description	
CS-020	SporView ^{MC} , ens. culture	20/bte
CS-100	SporView ^{MC} , ens. culture	100/bte
SK-037	SporView ^{MC} , ens. culture, trse dép. (chaleur sèche, gaz EtO)	ch.
NDB-036	Incubateur 37° C Dry Block, 13 mm (chaleur sèche, gaz EtO)	ch.
RN-025	Journal	ch.
TR-001	Support de transfert	ch.
N°	Description	
NSP-400	2 x 10 po poch. autoscel. nylon	100/bte
NSP-405	3 x 10 po poch. autoscel. nylon	100/bte
NSP-410	4 x 1 po" poch. autoscel. nylon	100/bte
NSP-420	7 x 10,5 po poch. autoscel. nylon	100/bte
NSP-430	9,5 x 13 po poch. autoscel. nylon	100/bte

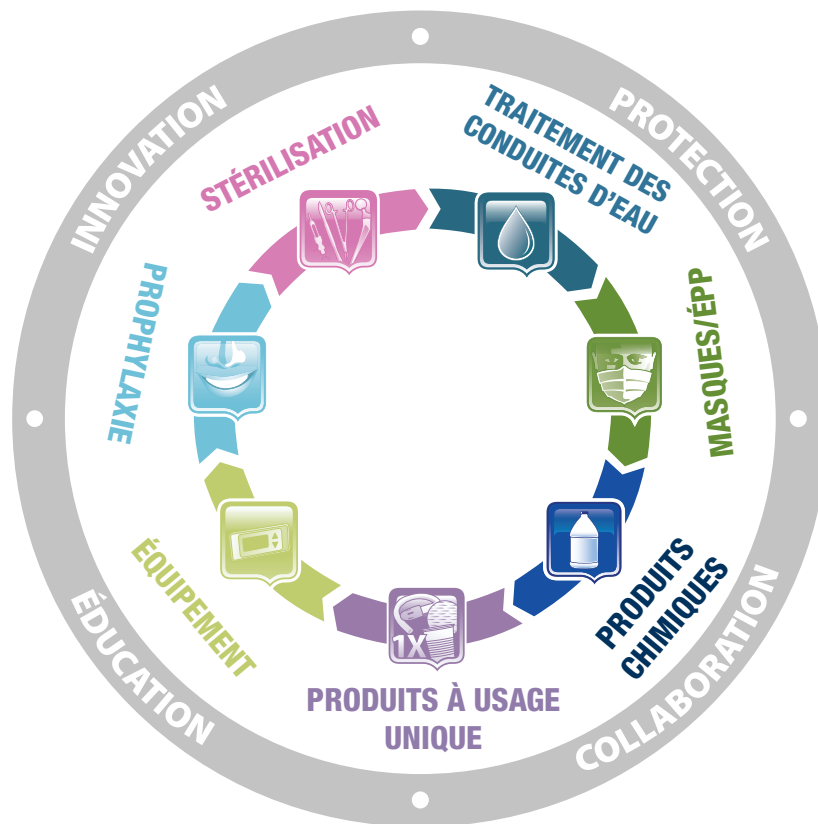

Engagés à faire des contributions vitales pour la santé par le biais de solutions de grande qualité, de services et d'éducation améliorant les résultats pour les professionnels dentaires et les patients.



Tous les produits sont fièrement fabriqués aux É.-U., sauf exception.

Tous les noms de produits sont des marques de commerce de Crosstex International Inc., une compagnie Cantel Medical, ses sociétés affiliées ou liées, sauf avis contraire.

crosstex.com | 888 276-7783

© 2018 Crosstex International, Inc. - 0718 DLIT00245

CROSSTEX
A CANTEL MEDICAL COMPANY